



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
معاونت غذا و دارو
اداره تجهیزات پزشکی

پارامتر های مهم در انتخاب دستگاه تست قند خون

تشخیص اصالت دستگاه تست قند خون

اولین و مهمترین نکته در انتخاب یک دستگاه مناسب، توجه به اصالت آن می باشد.

به همین منظور در سایت اداره کل تجهیزات پزشکی این امکان فراهم گردیده است تا با اجرای

مراحل زیر به سهولت به اطلاعات مورد نیاز دست یابید.

۱- مراجعه به سایت اداره کل تجهیزات پزشکی به نشانی

www.imed.ir



شکل ۱- مراجعه به آدرس اینترنتی سایت



۲- وارد شدن در قسمت استعلام



شکل ۲- ورود به قسمت استعلام

۳- وارد شدن در قسمت شرکت های نمایندگی (تولیدکنندگان)

شکل ۳- ورود به قسمت شرکت های نمایندگی



۴- تایپ عبارت " تست قند خون" در محل مشخص شده برای نام فارسی کالا و انتخاب گزینه جستجو.




شکل ۴- مرحله چهارم

در این مرحله لیستی از شرکت هایی را در اختیار خواهید داشت (شکل ۵) که در این زمینه


مورد تأیید اداره کل تجهیزات پزشکی کشور می باشند (با انتخاب "صفحه بعدی" که در

پایین صفحه وجود دارد، به ادامه لیست دسترسی خواهید داشت).

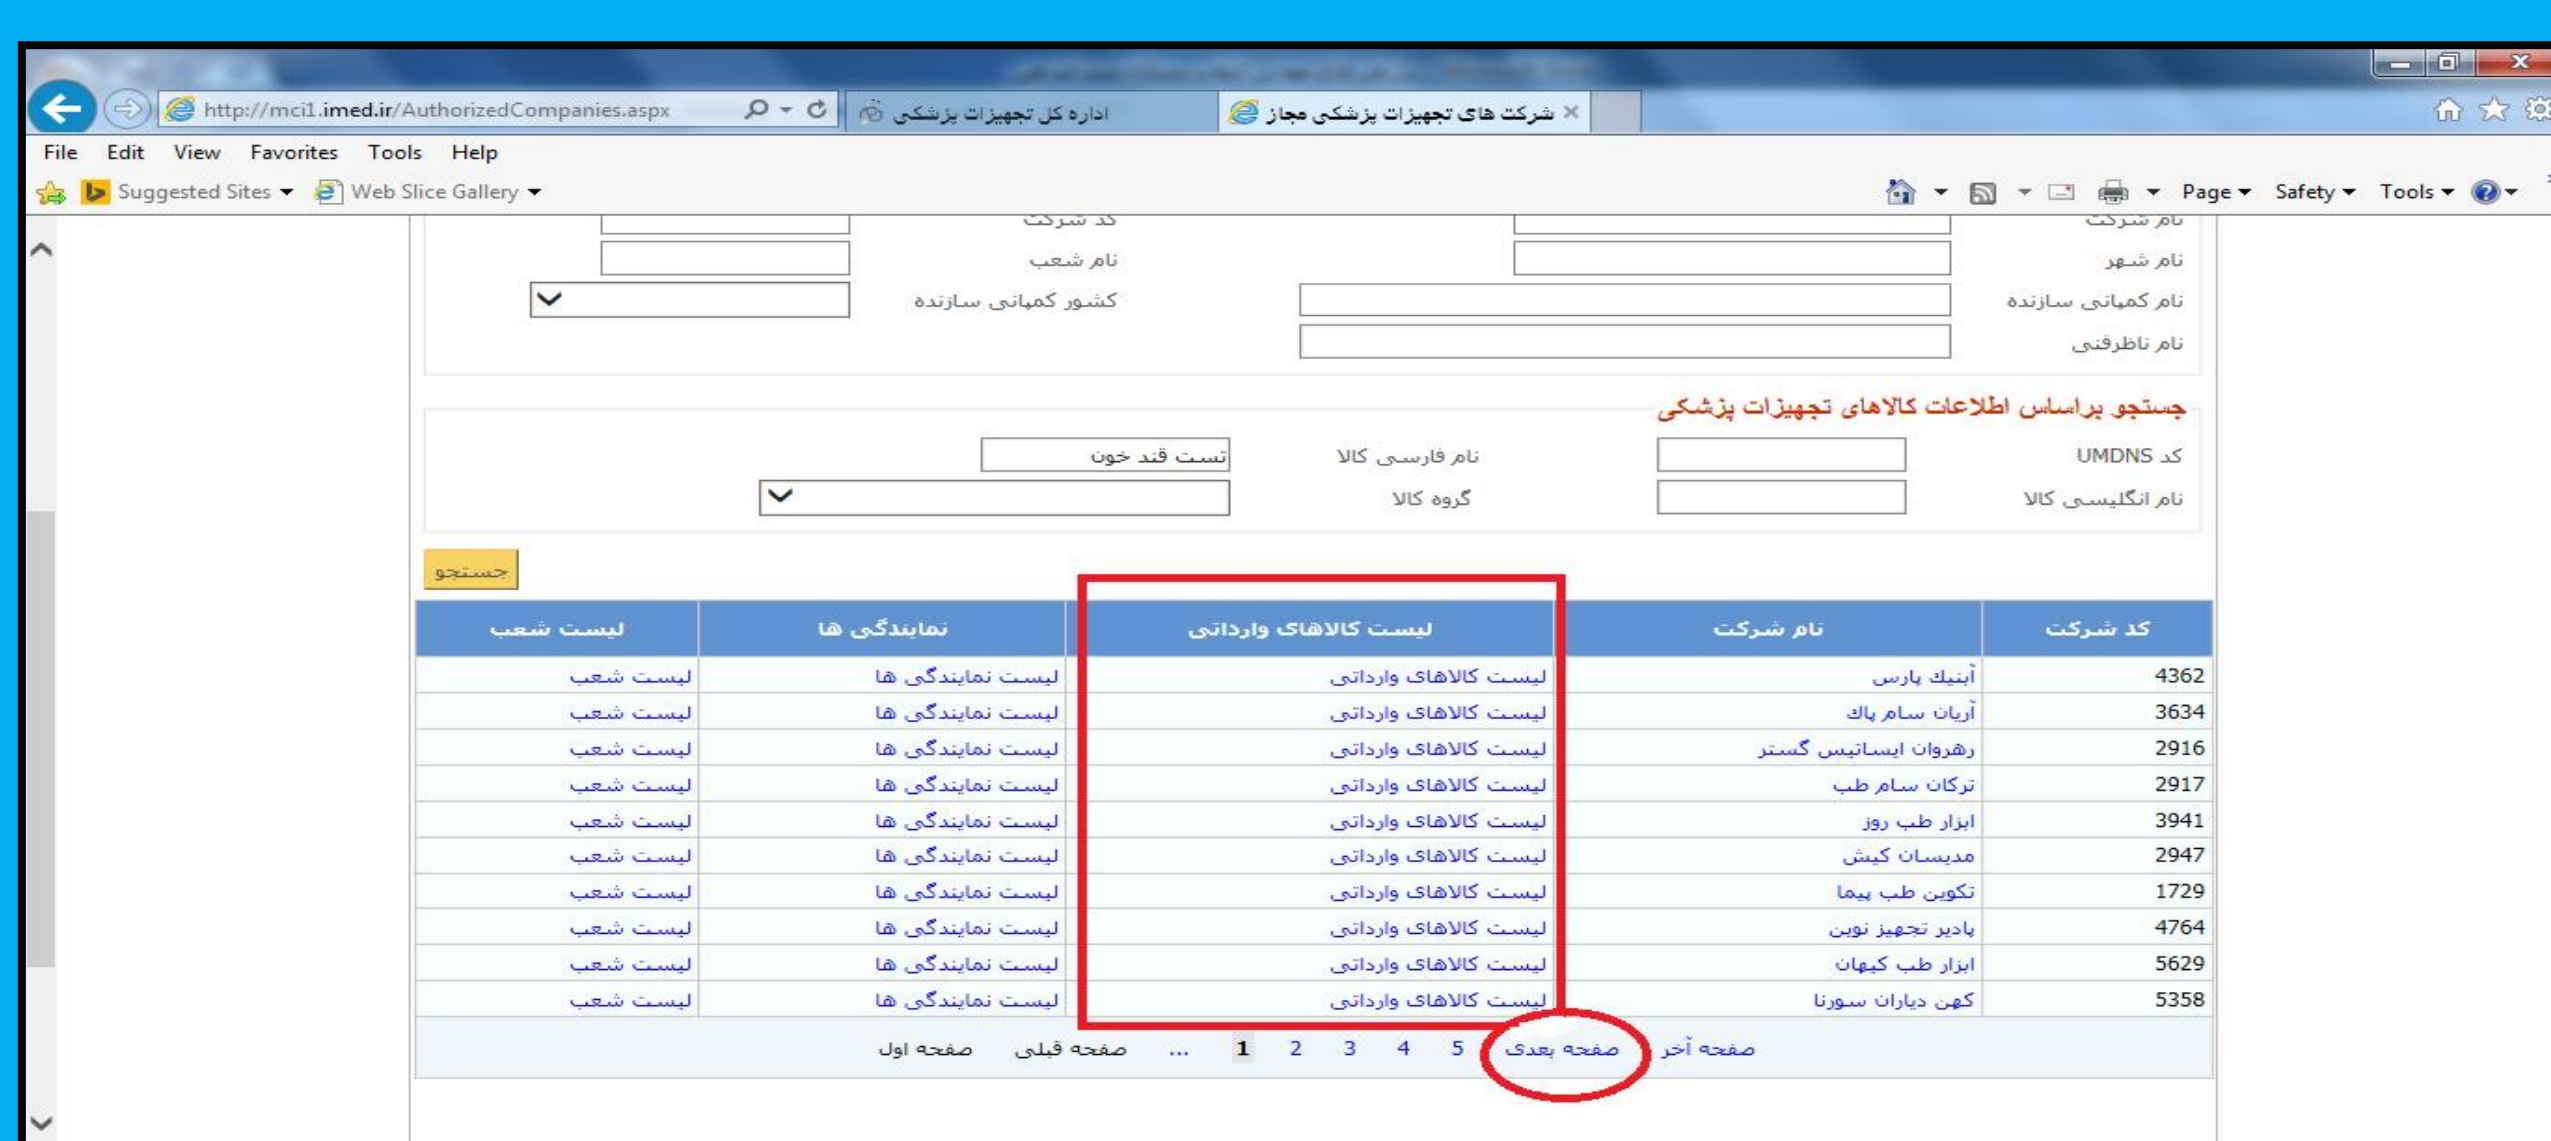

شکل ۵- لیست شرکت های نمایندگی

۵- باانتخاب گزینه ی لیست کالاهای وارداتی مربوط به هر شرکت، به اطلاعاتی همچون نام کالاهای وارداتی (دستگاه تست قند خون، نوار تست قند خون)، کمپانی سازنده، وضعیت نمایندگی و ... دست می یابید. این شرکت ها در صورتی مورد تأیید می باشند که وضعیت تاریخ نمایندگی آن ها معتبر باشد. همچنین بایستی از طریق داروخانه ها و نمایندگی های مجاز تجهیزات پزشکی خریداری گردد و در هنگام خرید به نام کمپانی سازنده و برچسب مربوط به شرکت نمایندگی (وارد کننده) توجه شود.

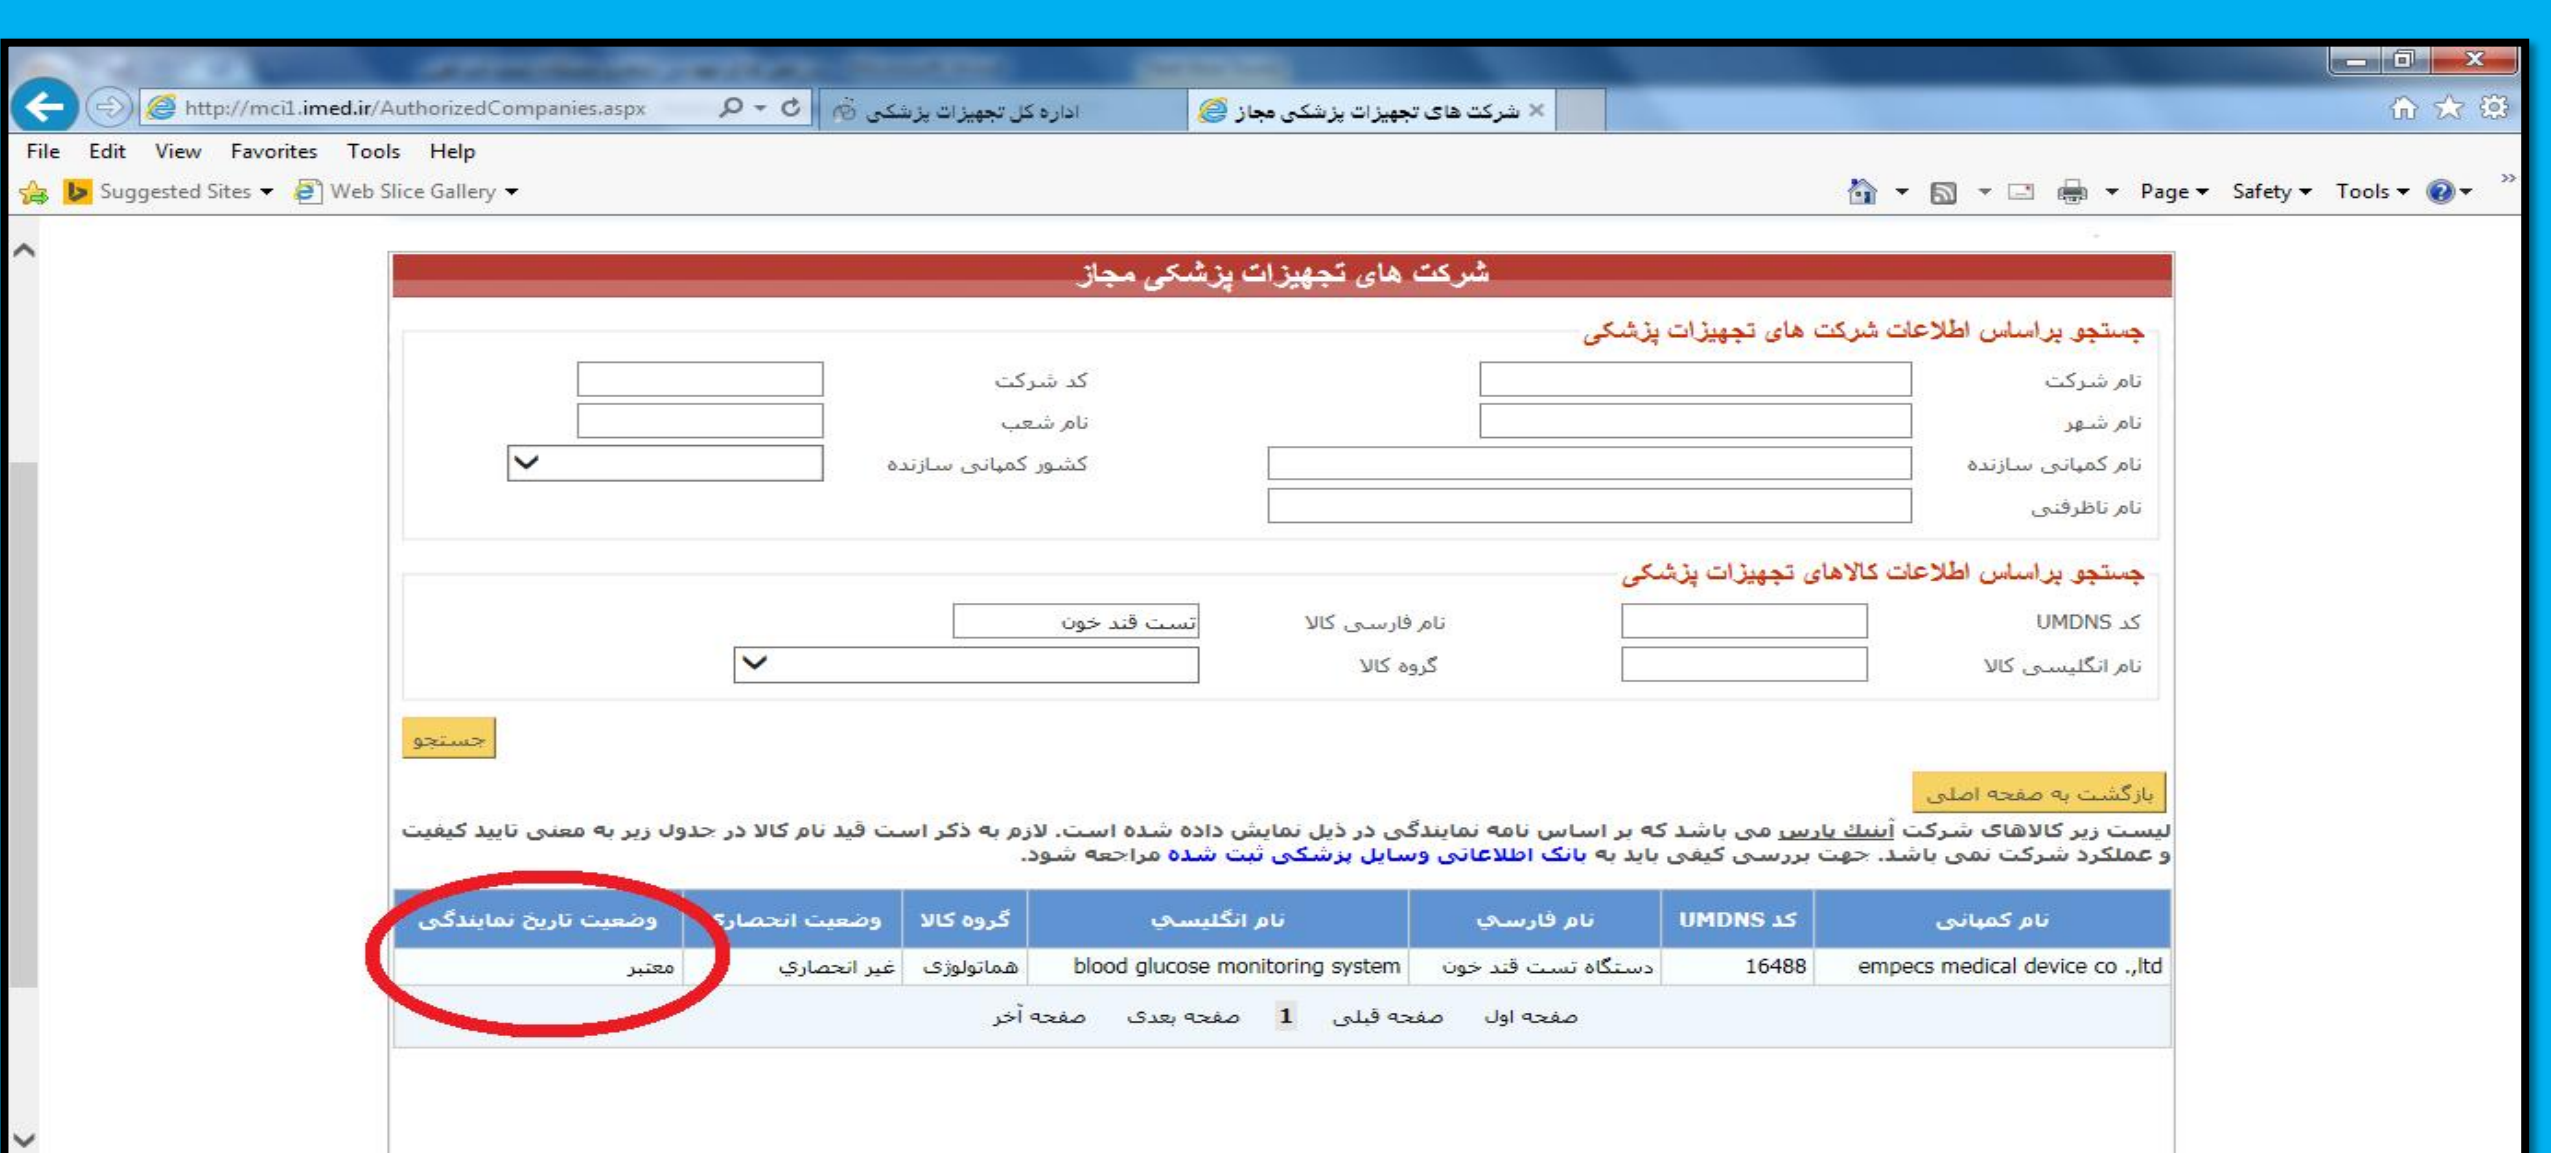

شکل ۶- وضعیت تاریخ نمایندگی بایستی معتبر باشد.

لازم به ذکر است قسمت جدیدی در سایت اداره تجهیزات در حال تکمیل است که قیمت های مصوب دستگاه ها نیز قابل مشاهده باشند که به زودی تکمیل خواهد شد و از قسمت قیمت های مصوب وسائل پزشکی قابل دسترسی خواهند بود.

منابع:

۱- سایت اداره کل تجهیزات پزشکی کشور www.imed.ir

۲- سایت انجمن اطلاع رسانی دیابت www.gabic.ir

دیگر نکات مورد توجه در انتخاب دستگاه بهتر:

❖ قابلیت حمل و نقل آسان

❖ سهولت در استفاده

✓ برخی دستگاه ها به هنگام استفاده نیاز به وارد کردن کد توسط کاربر دارند، ولی برخی دیگر از دستگاه ها این

کدگذاری را به صورت اتوماتیک انجام می دهند.

❖ مناسب بودن اندازه و کیفیت صفحه مانیتور

❖ داشتن حافظه ی کافی

❖ قابلیت اتصال به کامپیوتر

❖ سرعت بالا

❖ دقت بالا

❖ داشتن سیستم کنترل حجم خون

✓ هنگامی که حجم خون کمتر از مقدار استاندارد باشد،

اطظار دهد و مقدار اشتباهی را نمایش ندهد.

❖ در دسترس بودن نوار های تست قند خون مربوطه

✓ هر دستگاه نوار های تست قند خون مخصوص خود را داراست و در دسترس بودن آن ها با قیمت مناسب،

بسیار قابل توجه می باشد. در مراحل ذکر شده برای یافتن شرکت های نمایندگی مجاز از سایت اداره کل تجهیزات

پزشکی، در مرحله پنجم می توانید این موضوع را بررسی نمایید.

❖ داشتن خدمات پس از فروش مناسب

